


CERTIFICATE OF ANALYSIS

产品名称	Fire-Lumi™ 荧光素酶检测试剂盒
货号	L00877C-100
批号	R50123A00
规格	100 tests
保存条件	-20°C, 避光

产品测试结果

**Luminescence of Fire-Lumi Luciferase Kit
(Lot.R50123A00)**

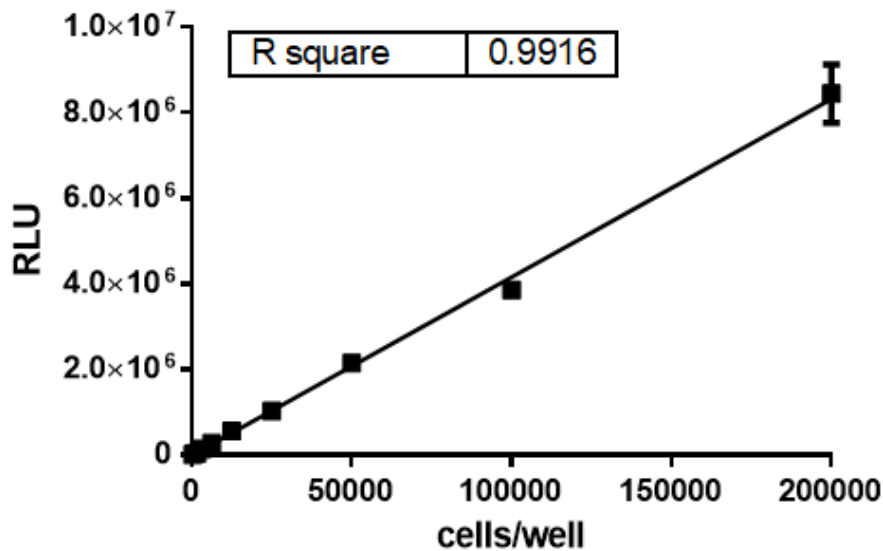

测试方法: 将稳定表达荧光素酶的 HEK293/NF- κ B pool 细胞, 按照不同密度种入 384 孔细胞培养板, 每孔含 40 μ l 培养基。将检测试剂融化平衡至室温, 按 40 μ l/孔加入细胞中, 经 Varioskan 读取化学发光信号。

检测项目	标准	结果
化学发光	>1E6/2E5 测试细胞	8.4E+06/2E5 cells
沉淀	视检无明显沉淀	未见

检测者: *Min Qiu*

日期: 11/01/2023